

Lote 1



Ficha Técnica do licitante: Licitante 1

Edital 2021.05.06.04-PERP REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAIOS X PORTÁTEIS E PROCESSADORA DE FILMES PARA RAIOS X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ MARIA PHILOMENOGOMES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACAJUS-CE. do Órgão Promotor Pacajus/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca

MEDITEC - MODELO MED 200

Especificação do Produto

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAIOS X PORTÁTEIS E PROCESSADORA DE FILMES PARA RAIOS X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ MARIA PHILOMENOGOMES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACAJUS-CE.

Data

Prazo de validade da proposta

Valor da Proposta

Impostos

ICMS

09/08/2021

IPI

60 dias

Informações Adicionais

R\$ 145.200,00

Impostos

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
LOCAÇÃO DE RAIOS X PORTÁTEIS	LOCAÇÃO DE RAIOS X PORTÁTEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ABAIXO - RAIOS X (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS): COMANDO: Com timer de altíssima precisão acoplado a coluna porta-tubo, com painel de policarbonato onde se encontram informações de leitura de Kv/mA, seletor de tempo de exposição e opção para selecionar mesa Bucky e ou Estativa Bucky Mural e ajuste de	12,00	Unidade	Lote	12.100,000000	12.100,000000	MEDITEC - MODELO MED 200

rede, sendo: - Seletor de Tempo, selecionando tempos de exposição desde 0,02" a 3.00" - Ajuste de compensação de rede 15% , acoplado a chave geral; - Ajuste de alta tensão de 40 a 100kv em 11 passos; - Ajuste de corrente de 40 a 100mA em 11 passos; e 40 a 100mA em 11 passos - Disparador a distância com 5 metros; - Alimentação de 220V AC / 60Hz - Tensão Monofásica. UNIDADE SELADA ÂNODO FIXO: Uma ampola produtora de Raios-X de ânodo fixo de 10KW, com capacidade para 200mA/100Kv, inserida em cúpula modelo CRX100, totalmente protegida até 150KW, proteção contra radiação, imersa em óleo mineral de alta isolamento. TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO: Monofásico, com capacidade para 100mA/100Kv, constituído em núcleo "C", imerso em óleo especial, equipado com 4 (quatro) retificadores de silício para 100Kv (retificador de onda completo), com saída em receptáculos "Machillet". COLUNA PORTA TUBO: Com pintura eletrostática, contrabalanceada por peso embutidos, dotada de sistema de freios mecânicos, com braço porta tubo recolhível de movimento longitudinal de 18 cm e recursos para movimentação da unidade selada, montada sobre rodízios para um fácil manuseio, movimento longitudinal e vertical. COLIMADOR LUMINOSO: Colimador luminoso manual, dotado de lâminas de chumbo, com timer eletrônico para desligar em 30seg., com lâmpada de foco de projeção halogênio de 100W, frente de acrílico, trilhos para instalação de cones especiais. CABOS DE ALTA TENSÃO: Par de Cabos Blindados de alta isolamento, equipado com terminais do tipo "Machillet" e respectivas guarnições, com 2,5mts.



Valor Total do Lance Inicial

R\$ 145.200,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 145.200,00

Especificação dos documentos anexados

No.

Descrição do documento

1

Proposta de preços locação raio x e processadora
pacajús.docx

[↓ DOWNLOAD](#)

Declaração de atendimento às condições do Edital -

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP -

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



PROPOSTA DE PREÇOS



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.05.06.04-PERP

À PREGOREIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS/CE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDA DE	QTDE	MARCA/MOD ELO	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
1	<p>LOCAÇÃO DE RAIOS X PORTÁTIL CONFORME ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ABAIXO – RAIOS X (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS): COMANDO: Com timer de altíssima precisão acoplado a coluna porta-tubo, com painel de policarbonato onde se encontram informações de leitura de Kv/mA, seletor de tempo de exposição e opção para selecionar mesa Bucky e ou Estativa Bucky Mural e ajuste de rede, sendo: - Seletor de Tempo, selecionando tempos de exposição desde 0,02" a 3.00" – Ajuste de compensação de rede 15%, acoplado a chave geral; - Ajuste de alta tensão de 40 a 100kv em 11 passos; Ajuste de corrente de 40 a 100mA em 11 passos; e 40 a 100mA em 11 passos – Disparador a distância com 5 metros; Alimentação de 220V AC / 60HZ – Tensão Monofásica. UNIDADE SELADA ÂNODO FIXO: Uma ampola produtora de Raios-X de ânodo fixo de 10KW, com capacidade para 200mA/100kv, inserida em cúpula modelo CRX100, totalmente protegida até 150KW, proteção contra radiação, imersa em óleo mineral de alta isolamento. TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO: Monofásico, com capacidade para 100mA/100kv, constituído em núcleo "C", imerso em óleo especial, equipado com 4 (quatro) retificadores de silício para 100kv (retificador de onde completo), com saída em receptáculos "Machillet". COLUNA PORTA TUBO: Com pintura eletrostática, contrabalanceada por peso embutidos, dotada de sistema de freios mecânicos, com braço porta tubo recolhível de movimento longitudinal de 18 cm e recursos para movimentação da unidade selada, montada sobre rodízios para um fácil manuseio, movimento longitudinal e vertical. COLIMADOR LUMINOSO: Colimador luminoso manual, dotado de lâminas de chumbo, com timer eletrônico para desligar em 30 seg., com lâmpada de foco de proteção halogênio de 100W, frente de acrílico, trilhos para instalação de cones especiais. CABOS DE ALTA TENSÃO: Par de Cabos Blindados de Alta isolamento, equipado com terminais do tipo "Machillet" e respectivas guarnições, com 2,5mts.</p>	MÊS	12	MARCA MEDITEC- MODELO MED 200	R\$ 12.100,00	R\$ 145.200,00

2	<p>Processadora automática para filmes de raio-x com as seguintes especificações mínimas: Capacidade mínima de processamento de 160 a 200 filmes/hora ajustáveis. Capacidade para processar filmes 10x10 até 35x43cm. Tempo de processamento mínimo de 90 a 240 s/hora ajustáveis. Ajustes mínimos de temperaturas, revelador 20-40°C, secador 25-70°C. Tanque em material resistente à corrosão de químicos. No mínimo dois sensores um em cada lado da bandeja da entrada do filme. Sensor de temperatura e de segurança interno nos tanques do revelador e fixador e secador. Capacidade máxima de tanques, do revelador 10ª, do fixador 10L, de água 11L. Consumo de água em processamento 03 a 51min ajustável sem consumo em stand bay. Sistema automático de Standy bay. Acionamento do sistema de revelação automático com a inserção do filme. Sistema de exaustão forçada. Sistema de circulação do revelador e fixador automático. Sistema de regeneração do revelador e fixador automático e ajustável. Sistema de proteção para o circuito de aquecimento do revelador, fixador e secador, Indicador luminoso de entrada do filme. Alarme sonoro ao final do processo de entrada do filme. Alimentação 220v – 50/60hz fio terra. Dimensões aproximadas altura 114cm com cavalete, largura 58cm, comprimento 115cm, peso máximo 94kg.</p>	MÊS	12	MARCA MACROTEC – MODLEO MX2	R\$ 3.800,00	R\$ 45.600,00
---	---	-----	----	--------------------------------------	--------------	---------------



Valor Global da Proposta: R\$ 190.800,00 (Cento e noventa mil e oitocentos reais).

Prazo de execução: os serviços deverão ser iniciados em até 05 (CINCO) DIAS, a contar da emissão da ORDEM DE SERVIÇOS.

Prazo de validade: 60 (sessenta) dias a contar da abertura da licitação

Declaramos que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o objeto licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos para os devidos fins que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta de preço está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (Edital).



Ficha Técnica do licitante: Licitante 2

Edital 2021.05.06.04-PERP REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO DE RAIOS X PORTÁTIL E PROCESSADORA DE FILMES PARA RAIOS X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ MARIA PHILOMENOGOMES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACAJUSCE. do Órgão Promotor Pacajus/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca

Crx

Especificação do Produto

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO DE RAIOS X PORTÁTIL E PROCESSADORA DE FILMES PARA RAIOS X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ MARIA PHILOMENOGOMES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACAJUSCE.

Data

Prazo de validade da proposta

Valor da Proposta

Impostos

ICMS

09/08/2021

IPI

60 dias

Informações Adicionais

R\$ 145.999,92

Impostos

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
LOCAÇÃO DE RAIOS X PORTÁTIL	LOCAÇÃO DE RAIOS X PORTÁTIL CONFORME ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ABAIXO - RAIOS X (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS): COMANDO: Com timer de altíssima precisão acoplado a coluna porta-tubo, com painel de policarbonato onde se encontram informações de leitura de Kv/mA, seletor de tempo de exposição e opção para selecionar mesa Bucky e ou Estativa Buckv Mural e ajuste de	12,00	Unidade	Lote	12.166,660000	12.166,660000	Crx



rede, sendo: - Seletor de Tempo, selecionando tempos de exposição desde 0,02" a 3,00" - Ajuste de compensação de rede 15% , acoplado a chave geral; - Ajuste de alta tensão de 40 a 100kv em 11 passos; - Ajuste de corrente de 40 a 100mA em 11 passos; e 40 a 100mA em 11 passos - Disparador a distância com 5 metros; - Alimentação de 220V AC / 60Hz - Tensão Monofásica. UNIDADE SELADA ÂNODO FIXO: Uma ampola produtora de Raios-X de ânodo fixo de 10KW, com capacidade para 200mA/100Kv, inserida em cúpula modelo CRX100, totalmente protegida até 150KW, proteção contra radiação, imersa em óleo mineral de alta isolamento. TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO: Monofásico, com capacidade para 100mA/100Kv, constituído em núcleo "C", imerso em óleo especial, equipado com 4 (quatro) retificadores de silício para 100Kv (retificador de onda completo), com saída em receptáculos "Machillet". COLUNA PORTA TUBO: Com pintura eletrostática, contrabalanceada por peso embutidos, dotada de sistema de freios mecânicos, com braço porta tubo recolhível de movimento longitudinal de 18 cm e recursos para movimentação da unidade selada, montada sobre rodízios para um fácil manuseio, movimento longitudinal e vertical. COLIMADOR LUMINOSO: Colimador luminoso manual, dotado de lâminas de chumbo, com timer eletrônico para desligar em 30seg., com lâmpada de foco de projeção halogênio de 100W, frente de acrílico, trilhos para instalação de cones especiais. CABOS DE ALTA TENSÃO: Par de Cabos Blindados de alta isolamento, equipado com terminais do tipo "Machillet" e respectivas guarnições, com 2,5mts.

Valor Total do Lance Inicial

R\$ 145.999,92

Valor Total do Lance Final

R\$ 145.999,92

Especificação dos documentos anexados

No.

Descrição do documento

1

Anexo Ficha Técnica - PE 2021.05.06.04 Pacajus -
Locação.pdf

↓ DOWNLOAD

Declaração de atendimento às condições do Edital -

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP -

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



LOCAL, 06 DE AGOSTO DE 2021.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍUS
Hospital Municipal José Maria Philomeno Gomes / Secretaria de Saúde
Comissão de Licitação

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAIOS X PORTÁTIL E PROCESSADORA DE FILMES PARA RAIOS X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ MARIA PHILOMENO GOMES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACAÍUS / CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

A) CONSIDERA-SE COMO PROPOSTA, NO VALOR TOTAL DE R\$ 191.999,88 (cento e noventa e um mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos);

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.05.06.04-PERP
ABERTURA: 10 / 08 / 2021 ÀS 09 : 00 H

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	UNIT. (R\$)		PROPOSTA ELETRÔNICA	
					extenso	total (R\$)	extenso	total (R\$)

LOTE 1



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UNID.	UNIT. (R\$)	extenso	PROPOSTA ELETRÔNICA	extenso	
1	<p>LOCAÇÃO DE RAO X PORTÁTIL CONFORME ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ABAIXO - RAO X (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS): COMANDO: com timer de altíssima precisão acoplado a coluna porta-tubo, com painel de policarbonato onde se encontram informações de leitura de kv/ma, seletor de tempo de exposição e opção para selecionar mesa bucky e ou estativa bucky mural e ajuste de rede, sendo: - seletor de tempo, selecionado tempos de exposição desde 0,02" a 3,00" - Ajuste de compensação de rede 15%, acoplado a chave geral; - Ajuste de alta tensão de 40 a 100 kv em 11 passos; - Ajuste de corrente de 40 a 100mA em 11 passos; e 40 a 100mA em 11 passos - Disparador a distância com 5 metros; - Alimentação de 220V AC/60Hz - Tensão monofásica. UNIDADE SELADA ANODO FIXO: uma ampola produtora de raios-x de ânodo fixo de 10kw, com capacidade para 200mA/100kv, inserida em cúpula modelo CRX100, totalmente protegida até 150Kw, proteção contra radiação, imersa em óleo mineral de alta isolamento. TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO: Monofásico, com capacidade para 100mA/100kv, constituído em núcleo "C", imerso em óleo especial, equipado com 4 (quatro) retificadores de silício para 100kv (retificador de onda completo), com saída em receptáculos "Machillet". COLUNA PORTA PORTA: com pintura eletrostática, contrabalaceada por peso embutidos, dotada de sistema de freios mecânicos, com braço porta tubo recolhível de movimento longitudinal de 18cm e recursos para movimentação da unidade selada, montada sobre rodízios para um fácil manuseio, movimento longitudinal e vertical. COLIMADOR LUMINOSO: colimador luminoso manual, dotado de lâminas de chumbo, com timer eletrônico para desligar em 30 seg., com lâmpada de foco de projeção halogênio de 100w, frente de acrílico, trilhos para instalação de cones especiais. CABOS DE ALTA TENSÃO: par de cabos blindados de alta isolamento, equipado com terminais do tipo "machillet" e respectivas guarnições, com 2,5m.</p>	CRX	12	MÊS	12.166,66	doze mil, e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos	doze mil, e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos	145.999,92	cento e quarenta e cinco mil, novecentos e noventa e dois centavos

145.999,92

cento e quarenta e cinco mil, novecentos e noventa e dois centavos

LOTE 2

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	UMIT. (R\$)	extenso	PROPOSTA ELETRÔNICA	extenso
------	-----------	-------	-------	-------	-------------	---------	---------------------	---------

1	Processadora automática para filmes de raio-x com as seguintes especificações mínimas: Capacidade mínima de processamento de 160 a 200 filmes/hora ajustáveis. Capacidade para processar filmes 10 x 10cm até 35 x 43cm. Tempo de processamento mínimo de 90 a 240 s/hora ajustáveis. Ajustes mínimos de temperaturas, revelador 20-40°C, secador 25-70°C. Tanque em material resistente à corrosão de químicos. No mínimo dois sensores um em cada lado da bandeja da entrada do filme. Sensor de temperatura e de segurança interno nos tanques do revelador e fixador e secador. Capacidade máxima dos tanques, do revelador 10L, do fixador 10L, de água 11L. Consumo de água em processamento 03 a 51 min ajustável, sem consumo em stand by. Sistema automático de Stand-by. Acionamento do sistema de revelação automático com a inserção do filme. Sistema de exaustão forçada. Sistema de circulação do revelador e fixador automático. Sistema de regeneração do revelador e fixador automático e ajustável. Sistema de proteção para o circuito de aquecimento do revelador, fixador e secador. Indicador luminoso de entrada do filme. Alarme sonoro ao final do processo de entrada do filme. Alimentação 220V - 50/60 Hz fio terra. Dimensões aproximadas altura 114cm com cavalete, largura 58cm, comprimento 115cm, peso máximo 94kg.	VISION LINE	12	MÉS	3.833,33	três mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos	45.999,96	quarenta e cinco mil, novecentos e noventa e seis centavos
---	---	-------------	----	-----	----------	---	-----------	--

45.999,96

quarenta e cinco mil, novecentos e noventa e seis centavos

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA.....R\$	cento e noventa e um mil, novecentos e noventa e oitenta e oito centavos	191.999,88
----------------------------------	--	------------

B) PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
C) PRAZO DE ENTREGA / EXECUÇÃO: conforme os termos deste edital e item 8 do Termo de Referência
D) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a contar da abertura da licitação
Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento/ execução licitada, inclusive a margem de lucro.
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).



Lote 2



Ficha Técnica do licitante: Licitante 1

Edital 2021.05.06.04-PERP REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO DE RAIOS X PORTÁTIL E PROCESSADORA DE FILMES PARA RAIOS X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ MARIA PHILOMENOGOMES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACAJUSCE. do Órgão Promotor Pacajus/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca

MACROTEC - MODELO MX2

Especificação do Produto

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO DE RAIOS X PORTÁTIL E PROCESSADORA DE FILMES PARA RAIOS X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ MARIA PHILOMENOGOMES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACAJUSCE.

Data

Prazo de validade da proposta

Valor da Proposta

Impostos

ICMS

09/08/2021

IPI

60 dias

Informações Adicionais

R\$ 45.600,00

Impostos

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
Processadora automática para filmes de raio-x	Processadora automática para filmes de raio-x com as seguintes especificações mínimas: . Capacidade mínima de processamento de 160 a 200 filmes/hora ajustáveis. Capacidade para processar filmes 10x10cm até 35x43cm. Tempo de processamento mínimo de 90 a 240 s/hora ajustáveis. Ajustes mínimos de	12,00	Unidade	Lote	3.800,000000	3.800,000000	MACROTEC - MODELO MX2

temperaturas,
 revelador 20-40°C,
 secador 25-70°C.
 Tanque em material resistente à corrosão de químicos. No mínimo dois sensores um em cada lado da bandeja da entrada do filme. Sensor de temperatura e de segurança interno nos tanques do revelador e fixador e secador. Capacidade máxima dos tanques, do revelador 10L, do fixador 10L, de água 11L. Consumo de água em processamento 03 a 51min ajustável, sem consumo em stand by. Sistema automático de Stand by. Acionamento do sistema de revelação automático com a inserção do filme. Sistema de exaustão forçada. Sistema de circulação do revelador e fixador automático. Sistema de regeneração do revelador e fixador automático e ajustável. Sistema de proteção para o circuito de aquecimento do revelador, fixador e secador. Indicador luminoso de entrada do filme. Alarme sonoro ao final do processo de entrada do filme. Alimentação 220v - 50/60hz fio terra. Dimensões aproximadas altura 114cm com cavalete, largura 58cm, comprimento 115cm, peso máximo 94kg.



Valor Total do Lance Inicial

R\$ 45.600,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 45.600,00

Especificação dos documentos anexados

No.	Descrição do documento
1	Proposta de preços locação raio x e processadora pacajús.docx

[↓ DOWNLOAD](#)

Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

Declaramos que estamos sob o regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



PROPOSTA DE PREÇOS



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.05.06.04-PERP

À PREGOREIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS/CE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDA DE	QTDE	MARCA/MOD ELO	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
1	<p>LOCAÇÃO DE RAIOS X PORTÁTIL CONFORME ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ABAIXO – RAIOS X (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS):</p> <p>COMANDO: Com timer de altíssima precisão acoplado a coluna porta-tubo, com painel de policarbonato onde se encontram informações de leitura de Kv/mA, seletor de tempo de exposição e opção para selecionar mesa Bucky e ou Estativa Bucky Mural e ajuste de rede, sendo: - Seletor de Tempo, selecionando tempos de exposição desde 0,02" a 3.00" – Ajuste de compensação de rede 15%, acoplado a chave geral; - Ajuste de alta tensão de 40 a 100kv em 11 passos; Ajuste de corrente de 40 a 100mA em 11 passos; e 40 a 100mA em 11 passos – Disparador a distância com 5 metros; Alimentação de 220V AC / 60HZ – Tensão Monofásica. UNIDADE SELADA ÂNODO FIXO: Uma ampola produtora de Raios-X de ânodo fixo de 10KW, com capacidade para 200mA/100kv, inserida em cúpula modelo CRX100, totalmente protegida até 150KW, proteção contra radiação, imersa em óleo mineral de alta isolamento. TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO: Monofásico, com capacidade para 100mA/100kv, constituído em núcleo "C", imerso em óleo especial, equipado com 4 (quatro) retificadores de silício para 100kv (retificador de onde completo), com saída em receptáculos "Machillet". COLUNA PORTA TUBO: Com pintura eletrostática, contrabalanceada por peso embutidos, dotada de sistema de freios mecânicos, com braço porta tubo recolhível de movimento longitudinal de 18 cm e recursos para movimentação da unidade selada, montada sobre rodízios para um fácil manuseio, movimento longitudinal e vertical. COLIMADOR LUMINOSO: Colimador luminoso manual, dotado de lâminas de chumbo, com timer eletrônico para desligar em 30 seg., com lâmpada de foco de proteção halogênio de 100W, frente de acrílico, trilhos para instalação de cones especiais. CABOS DE ALTA TENSÃO: Par de Cabos Blindados de Alta isolamento, equipado com terminais do tipo "Machillet" e respectivas guarnições, com 2,5mts.</p>	MÊS	12	MARCA MEDITEC- MODELO MED 200	R\$ 12.100,00	R\$ 145.200,00

2	<p>Processadora automática para filmes de raio-x com as seguintes especificações mínimas: Capacidade mínima de processamento de 160 a 200 filmes/hora ajustáveis. Capacidade para processar filmes 10x10 até 35x43cm. Tempo de processamento mínimo de 90 a 240 s/hora ajustáveis. Ajustes mínimos de temperaturas, revelador 20-40°C, secador 25-70°C. Tanque em material resistente à corrosão de químicos. No mínimo dois sensores um em cada lado da bandeja da entrada do filme. Sensor de temperatura e de segurança interno nos tanques do revelador e fixador e secador. Capacidade máxima de tanques, do revelador 10ª, do fixador 10L, de água 11L. Consumo de água em processamento 03 a 51min ajustável sem consumo em stand bay. Sistema automático de Standy bay. Acionamento do sistema de revelação automático com a inserção do filme. Sistema de exaustão forçada. Sistema de circulação do revelador e fixador automático. Sistema de regeneração do revelador e fixador automático e ajustável. Sistema de proteção para o circuito de aquecimento do revelador, fixador e secador, Indicador luminoso de entrada do filme. Alarme sonoro ao final do processo de entrada do filme. Alimentação 220v – 50/60hz fio terra. Dimensões aproximadas altura 114cm com cavalete, largura 58cm, comprimento 115cm, peso máximo 94kg.</p>	MÊS	12	<p>MARCA MACROTEC – MODLEO MX2</p>	R\$ 3.800,00	R\$ 45.600,00
---	---	-----	----	--	--------------	---------------



Valor Global da Proposta: R\$ 190.800,00 (Cento e noventa mil e oitocentos reais).

Prazo de execução: os serviços deverão ser iniciados em até 05 (CINCO) DIAS, a contar da emissão da ORDEM DE SERVIÇOS.

Prazo de validade: 60 (sessenta) dias a contar da abertura da licitação

Declaramos que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o objeto licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos para os devidos fins que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta de preço está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (Edital).



Ficha Técnica do licitante: Licitante 3

Edital 2021.05.06.04-PERP REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO DE RAIOS X PORTÁTEIS E PROCESSADORA DE FILMES PARA RAIOS X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ MARIA PHILOMENOGOMES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACAJUSCE. do Órgão Promotor Pacajus/CE

Unidade Compradora**Razão Social:****CNPJ / CPF****Telefone****E-mail****Marca**

marca propria

Especificação do Produto**Data****Prazo de validade da proposta****Valor da Proposta****Impostos****ICMS**

10/08/2021

IPI

60 dias

Informações Adicionais

R\$ 45.600,00

Impostos

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
Processadora automática para filmes de raio-x	Processadora automática para filmes de raio-x com as seguintes especificações mínimas: . Capacidade mínima de processamento de 160 a 200 filmes/hora ajustáveis. Capacidade para processar filmes 10x10cm até 35x43cm. Tempo de processamento mínimo de 90 a 240 s/hora ajustáveis. Ajustes mínimos de temperaturas, revelador	12,00	Unidade	Lote	3.800,000000	3.800,000000	marca propria

20-40°C, secador 25-70°C. Tanque em material resistente à corrosão de químicos. No mínimo dois sensores um em cada lado da bandeja da entrada do filme. Sensor de temperatura e de segurança interno nos tanques do revelador e fixador e secador. Capacidade máxima dos tanques, do revelador 10L, do fixador 10L, de água 11L. Consumo de água em processamento 03 a 51min ajustável, sem consumo em stand by. Sistema automático de Stand by. Acionamento do sistema de revelação automático com a inserção do filme. Sistema de exaustão forçada. Sistema de circulação do revelador e fixador automático. Sistema de regeneração do revelador e fixador automático e ajustável. Sistema de proteção para o circuito de aquecimento do revelador, fixador e secador. Indicador luminoso de entrada do filme. Alarme sonoro ao final do processo de entrada do filme. Alimentação 220v - 50/60hz fio terra. Dimensões aproximadas altura 114cm com cavalete, largura 58cm, comprimento 115cm, peso máximo 94kg.



Valor Total do Lance Inicial

R\$ 45.600,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 45.600,00

Especificação dos documentos anexados

No.	Descrição do documento
1	1 - PROCESSADORA.pdf ↓ DOWNLOAD

Declaracao de atendimento às condições do Edital


Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

Processadoras automáticas para filmes

LX-M para filmes de mamografia

LX-2 para filmes de raios X

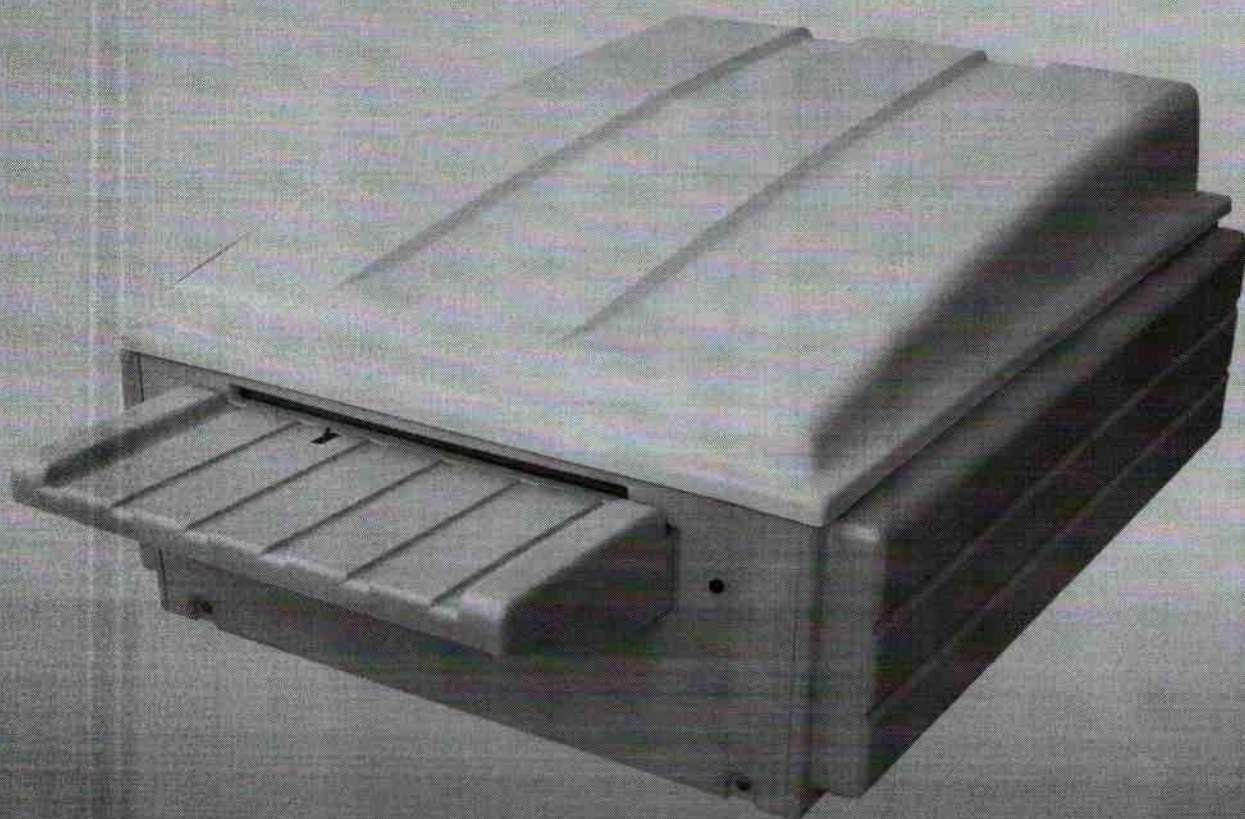

Projetadas para atender a todos os filmes radiológicos, aliando alta tecnologia, agilidade e baixo custo


LOTUS
healthcare

Processadoras automáticas para filmes


LX-M para filmes de mamografia e LX-2 para filmes de raios X



- Revela filmes de 100 mm até 360 mm;
- Racks com laterais injetadas em plástico nas cores vermelha, azul e cinza para o revelador, fixador e água respectivamente;
- Fácil manutenção e limpeza, leves e sem encaixes ou molas de fixação;
- Rolos de tração fabricados em Poliuretano (PU) de alta resistência e borrachas especiais;
- Estrutura monobloco em aço inox, com fechamentos laterais/superiores e tanques internos de químicos em material plástico injetado, resistente a corrosão;
- Cavalete de sustentação em aço inox;
- Tanques externos para reposição de químicos com capacidade de até 50 litros.
- Reposição automática e manual independentes para os químicos revelador e fixador com taxas ajustáveis;
- Tempo de processo ajustável;
- Controle de consumo de energia (stand-by) automático e programável;
- Sensor de nível independente com aviso sonoro e visual para revelador e fixador;
- Painel de controle externo, com display de cristal líquido para controle e programação das funções ao alcance do usuário;
- Acionamento automático para início de processo através de sensor de entrada de filme.
- Informação visual e sonora da entrada de filme;
- Controle de temperatura independente para o revelador, fixador e secador de variação $\pm 0,1^\circ\text{C}$;
- Sensores termostáticos de segurança para proteção de superaquecimento no revelador, fixador e secador;
- Sistema de circulação para os químicos, composto por bombas eletromagnéticas com filtragem;
- Disjuntor de segurança integrado ao equipamento (chave liga/desliga);
- Placa eletrônica com tecnologia microprocessada possibilitando, entre outros, os ajustes de tempo de processo, temperaturas dos químicos e secador, tempo de stand-by, taxas de consumo de químico;
- Exaustor interno de gases;
- Completo conjunto de acessórios para a instalação do equipamento, incluindo divisória para câmara clara/escura.



PAINEL DE CONTROLE EXTERNO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO



CAVALETE EM AÇO INOX



RACKS COM LATERAIS INJETADAS A CORES

LINHA DE ENTRADA DE FILME	100 A 360 mm
CAPACIDADE DE PRODUÇÃO	220 filmes/hora (tamanho 350x430 mm)*
TEMPO DE PROCESSO SECO-A-SECO	Ajustável de 90 a 300s (segundos)
CAPACIDADE DOS TANQUES	Revelador - até 11 litros Fixador - até 11 litros Água - até 10 litros
TEMPERATURAS	Revelador - ajustável de 20 °C a 40 °C Fixador - ajustável de 20 °C a 40 °C FIXADOR - ajustável de 20 °C a 40 °C
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V 50/60Hz + aterramento
DIMENSÕES	Altura - 1110 mm c/ cavalete e 400 mm s/ cavalete Largura - 710 mm Comprimento - 890 mm s/ o cesto e a bandeja

* Os filmes injetados utilizam um sistema de parâmetros de produção otimizados para este modelo.



BPF

BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO

PRODUTO REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE

DISTRIBUIDOR

FONE (41) 3074 2100

www.lotushealthcare.com.br - vendas@lotusindustria.com.br

LOTUS
healthcare



Ficha Técnica do licitante: Licitante 2

Edital 2021.05.06.04-PERP REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO DE RAIOS X PORTÁTIL E PROCESSADORA DE FILMES PARA RAIOS X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ MARIA PHILOMENOGOMES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACAJUSCE. do Órgão Promotor Pacajus/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca

Vision Line

Especificação do Produto

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO DE RAIOS X PORTÁTIL E PROCESSADORA DE FILMES PARA RAIOS X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ MARIA PHILOMENOGOMES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACAJUSCE.

Data

Prazo de validade da proposta

Valor da Proposta

Impostos

ICMS

09/08/2021

IPI

60 dias

Informações Adicionais

R\$ 45.999,96

Impostos

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
Processadora automática para filmes de raio-x	Processadora automática para filmes de raio-x com as seguintes especificações mínimas: . Capacidade mínima de processamento de 160 a 200 filmes/hora ajustáveis. Capacidade para processar filmes 10x10cm até 35x43cm. Tempo de processamento mínimo de 90 a 240 s/hora ajustáveis. Ajustes mínimos de temperaturas. revelador	12,00	Unidade	Lote	3.833,330000	3.833,330000	Vision Line

20-40°C, secador 25-70°C. Tanque em material resistente à corrosão de químicos. No mínimo dois sensores um em cada lado da bandeja da entrada do filme. Sensor de temperatura e de segurança interno nos tanques do revelador e fixador e secador. Capacidade máxima dos tanques, do revelador 10L, do fixador 10L, de água 11L. Consumo de água em processamento 03 a 51min ajustável, sem consumo em stand by. Sistema automático de Stand by. Acionamento do sistema de revelação automático com a inserção do filme. Sistema de exaustão forçada. Sistema de circulação do revelador e fixador automático. Sistema de regeneração do revelador e fixador automático e ajustável. Sistema de proteção para o circuito de aquecimento do revelador, fixador e secador. Indicador luminoso de entrada do filme. Alarme sonoro ao final do processo de entrada do filme. Alimentação 220v - 50/60hz fio terra. Dimensões aproximadas altura 114cm com cavalete, largura 58cm, comprimento 115cm, peso máximo 94kg.



Valor Total do Lance Inicial

R\$ 45.999,96

Valor Total do Lance Final

R\$ 45.999,96

Especificação dos documentos anexados

No.	Descrição do documento
1	Anexo Ficha Técnica - PE 2021.05.06.04 Pacajus - Locação.pdf

[↓ DOWNLOAD](#)

Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

LOCAL, 06 DE AGOSTO DE 2021.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS
Hospital Municipal José Maria Philomeno Gomes / Secretariat de Saúde
Comissão de Licitação

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAIOS X PORTÁTIL E PROCESSADORA DE FILMES PARA RAIOS X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ MARIA PHILOMENO GOMES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACAJUS / CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

A) CONSIDERA-SE COMO PROPOSTA, NO VALOR TOTAL DE R\$ 191.999,88 (cento e noventa e um mil, novecentos e noventa e nove reais e oito centavos):

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.05.06.04-PERP
ABERTURA: 10 / 08 / 2021 ÀS 09 : 00 H

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	UNIT. (R\$)	PROPOSTA ELETRÔNICA	
						extenso	TOTAL (R\$)
						extenso	

LOTE 1



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	UNIT. (R\$)	extenso	PROPOSTA ELETRÔNICA	extenso
							TOTAL (R\$)	

1	<p>LOCAÇÃO DE RAO X PORTÁTIL CONFORME ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ABAIXO - RAO X (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS): COMANDO: com timer de altíssima precisão acoplado a coluna porta-tubo, com painel de policarbonato onde se encontram informações de leitura de kv/ma, seletor de tempo de exposição e opção para selecionar mesa bucky e ou estativa bucky mural e ajuste de rede, sendo: - seletor de tempo, selecionado tempos de exposição desde 0,02" a 3,00" - Ajuste de compensação de rede 15%, acoplado a chave geral; - Ajuste de alta tensão de 40 a 100 kv em 11 passos; - Ajuste de corrente de 40 a 100mA em 11 passos; e 40 a 100mA em 11 passos - Disparador a distância com 5 metros; - Alimentação de 220V AC/60Hz - Tensão monofásica. UNIDADE SELADA ANODO FIXO: uma ampola produtora de raios-x de ânodo fixo de 10kw, com capacidade para 200mA/100kv, inserida em cúpula modelo CRX100, totalmente protegida até 150Kw, proteção contra radiação, imersa em óleo mineral de alta isolamento. TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO: Monofásico, com capacidade para 100mA/100kv, constituído em núcleo "C", imerso em óleo especial, equipado com 4 (quatro) retificadores de silício para 100kv (retificador de onda completo), com saída em receptáculos "Machillet". COLUNA PORTA PORTA: com pintura eletrostática, contrabalaceada por peso embutidos, dotada de sistema de freios mecânicos, com braço porta tubo recolhível de movimento longitudinal de 18cm e recursos para movimentação da unidade selada, montada sobre rodízios para um fácil manuseio, movimento longitudinal e vertical. COLIMADOR LUMINOSO: colimador luminoso manual, dotado de lâminas de chumbo, com timer eletrônico para desligar em 30 seg., com lâmpada de foco de projeção halogênio de 100w, frente de acrílico, trilhos para instalação de cones especiais. CABOS DE ALTA TENSÃO: par de cabos blindados de alta isolamento, equipado com terminais do tipo "machillet" e respectivas guarnições, com 2,5m.</p>	CRX	12	MÊS	12.166,66	doze mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos	145.999,92	cento e quarenta e cinco mil, novecentos e noventa e dois centavos
---	---	-----	----	-----	-----------	--	------------	--

LOTE 2

145.999,92

cento e quarenta e cinco mil, novecentos e noventa e dois centavos



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE	UNID.	UNIT. (R\$)	PROPOSTA ELETRÔNICA	extensão
						TOTAL (R\$)	

1	Processadora automática para filmes de raió-x com as seguintes especificações mínimas: Capacidade mínima de processamento de 160 a 200 filmes/hora ajustáveis. Capacidade para processar filmes 10 x 10cm até 35 x 43cm. Tempo de processamento mínimo de 90 a 240 s/hora ajustáveis. Ajustes mínimos de temperaturas, revelador 20-40°C, secador 25-70°C. Tanque em material resistente à corrosão de químicos. No mínimo dois sensores um em cada lado da bandeja de entrada do filme. Sensor de temperatura e de segurança interno nos tanques do revelador e fixador e secador. Capacidade máxima dos tanques, do revelador 10L, do fixador 10L, de água 11L. Consumo de água em processamento 03 a 51 min ajustável, sem consumo em stand by. Sistema automático de Stand-by. Acionamento do sistema de revelação automático com a inserção do filme. Sistema de exaustão forçada. Sistema de circulação do revelador e fixador automático. Sistema de regeneração do revelador e fixador automático e ajustável. Sistema de proteção para o circuito de aquecimento do revelador, fixador e secador. Indicador luminoso de entrada do filme. Alarme sonoro ao final do processo de entrada do filme. Alimentação 220V – 50/60 Hz fio terra. Dimensões aproximadas altura 114cm com cavalete, largura 58cm, comprimento 115cm, peso máximo 94kg.	VISION LINE	12	MÉS	3.833,33	45.999,96	quarenta e cinco mil, novecentos e noventa e seis centavos
---	---	-------------	----	-----	----------	-----------	--

45.999,96

quarenta e cinco mil, novecentos e noventa e seis centavos

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA.....R\$ 191.989,88

cento e noventa e um mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos

- B) PAGAMENTO: CONFORME EDITAL**
- C) PRAZO DE ENTREGA / EXECUÇÃO: conforme os termos deste edital e item 8 do Termo de Referência**
- D) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a contar da abertura da licitação**
- Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento/ execução licitado, inclusive a margem de lucro.
- Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

